

検査容器変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、別掲の検査容器におきましては、一部を変更させて頂きたくご案内いたします。
誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目および変更内容

※詳細につきましては、裏面内容をご参照願います。

容器変更日

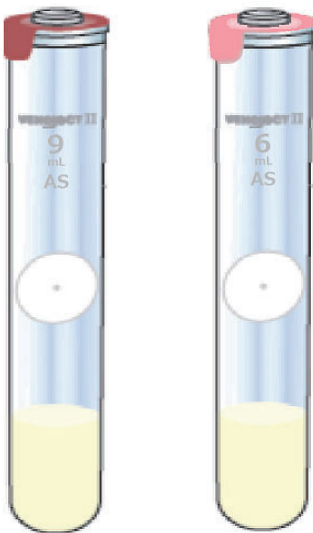
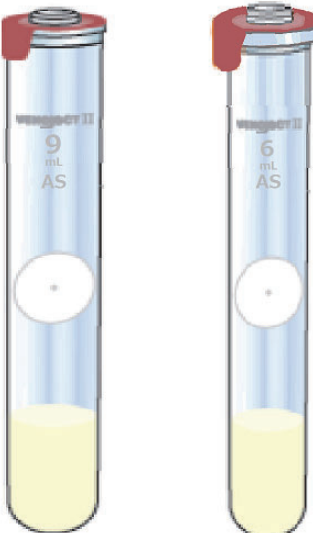
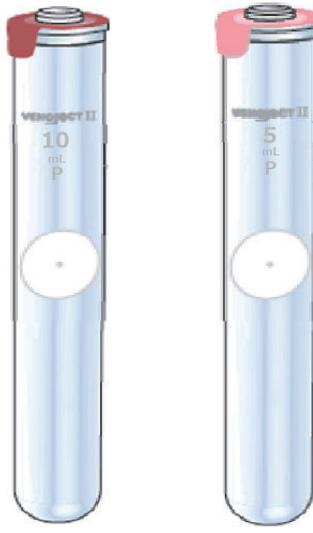

2023年1月4日（水）受託分より変更



保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL. 045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL. 048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL. 075-933-6060

変更内容

容器 コード	容器名称	新	現
A1	普通採血管 (分離剤入り)	 <p>9mL採血管 (変更無し)</p> <p>6mL採血管 (変更)</p>	 <p>9mL採血管</p> <p>6mL採血管</p>
A2	普通採血管 (分離剤無し)	 <p>10mL採血管 (変更無し)</p> <p>5mL採血管 (新規)</p>	 <p>10mL採血管</p>

変更内容

容器コード	容器名称	新	現
E	EDTA-2Na採血管	 <p style="text-align: center;">2mℓ・5mℓ採血管</p>	
P	血沈検査専用採血管	 <p style="text-align: center;">※1月4日以降、専用容器のご提出が必須となりますのでご注意ください。</p>	
ネ	アプロチニン入りEDTA試験管		

変更内容

容器 コード	容器名称	新	現
ト	ウイルス分離・同定 検査用培養細胞 試験管		